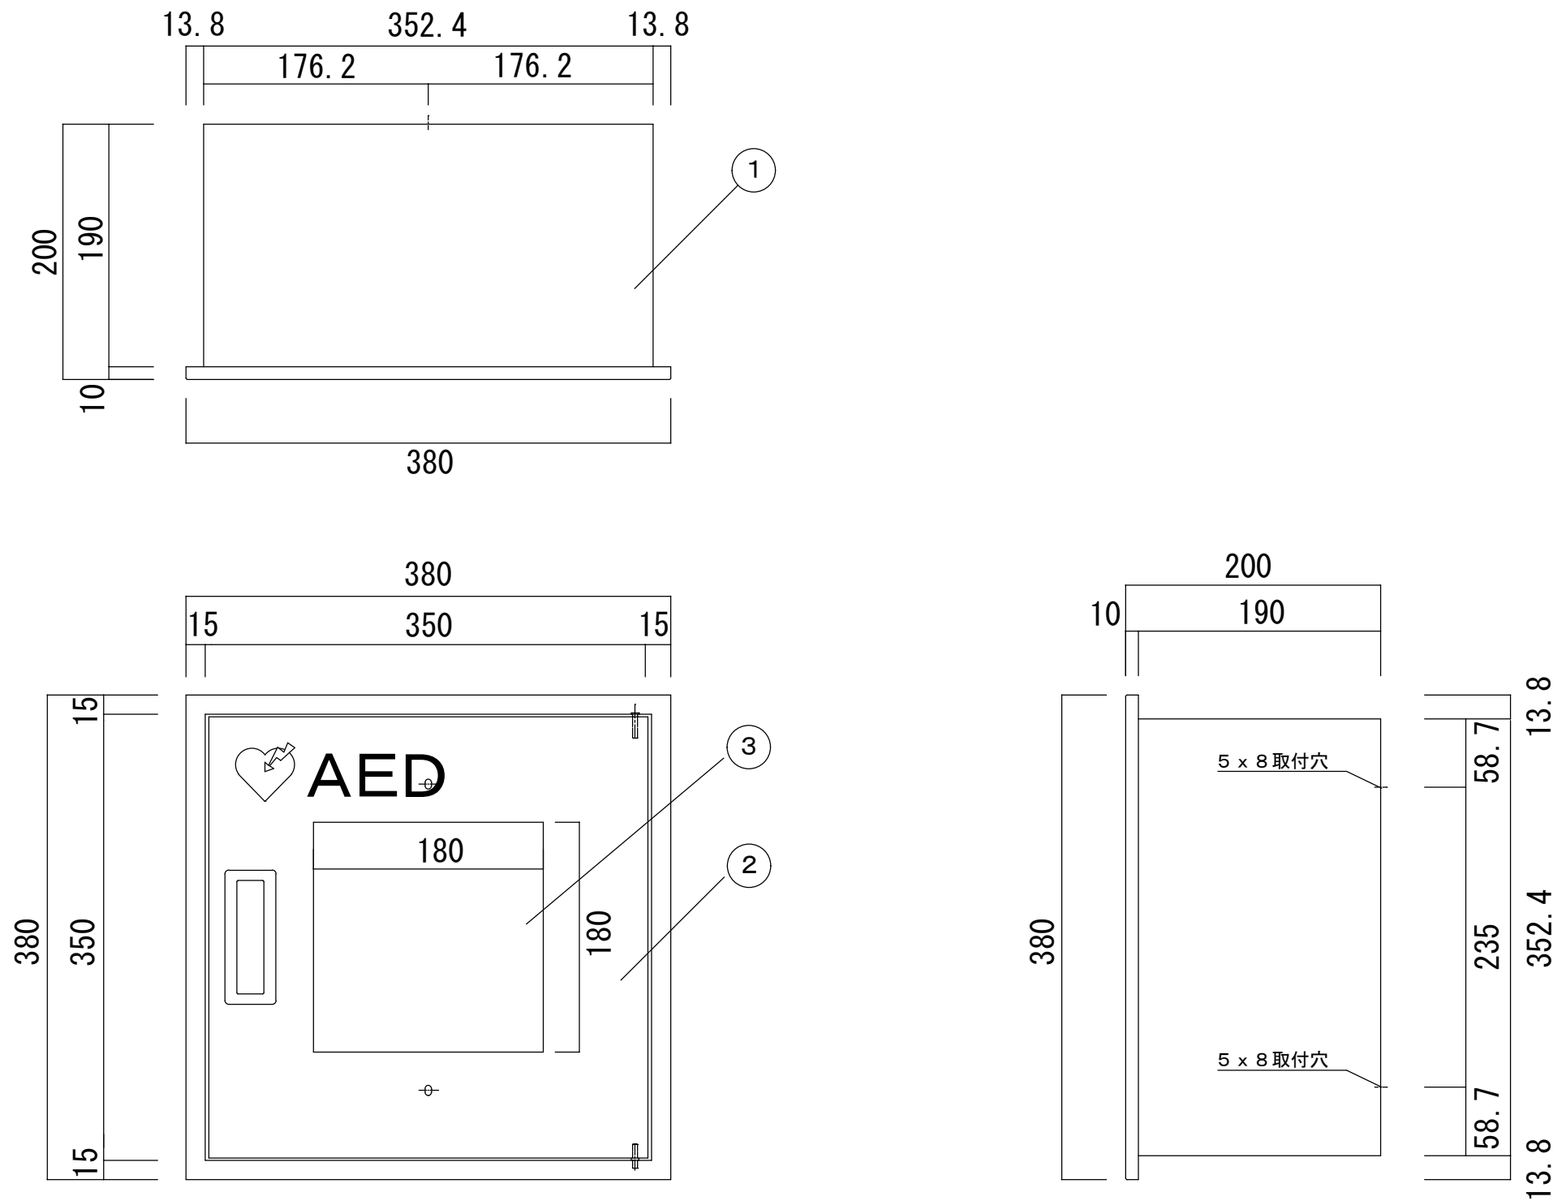


※ご発注前にご収納されますＡＥＤ機器寸法をご確認下さい

| 変番 | 日付 | 変更内容 |
|---|---|---|
| | 2020/3/21 | 自動体外式除細動器・緊急時以外使用禁止　シール削除 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場名 | | 1 | 本体 | ｽﾁｰﾙ t1.2 | ﾎﾟﾘｯｼｭﾎﾜｲﾄ | 焼付け塗装 | 7 | | | | | 商品名　ＡＥＤボックス | まんてん |
| | | 2 | 扉 | ｽﾁｰﾙ t1.0 | ﾎﾟﾘｯｼｭﾎﾜｲﾄ | 焼付け塗装 | 8 | | | | | ＭＤＸ－２２０ＮＷ | |
| 設計・監理 | | 3 | ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ | ｱｸﾘﾙ t5.0 | ｸﾘｱ | | 9 | | | | | | 縮尺　1/5　(A3) |
| | 殿 | 4 | | | | | 10 | | | | | | |
| 施工業者 | | 5 | | | | | 11 | | | | | 担当　中尾　作図　中村　数量 | 作成年月日　2026/01/17 |
| | 殿 | 6 | | | | | 12 | | | | | | |